

会社概要

所在地：岐阜県各務原市川島竹早町3番地

設立：1968年11月21日

代表取締役：木下康

資本金：80,000,000円

(テルモ株式会社100%出資)

従業員数：164名

業務内容：医療機器製造業

企業理念・方針・沿革等

【企業理念】

医療を通じて社会に貢献します

【ミッション】

先進医療の現場を先進の医療機器で支える

ドクターとともに理想の医療を実現する

医療に係わる人をサポートする

主な取り扱い製品

テルモ・クリニカルサプライ株式会社は血管内に挿入し治療を行うカテーテルを中心に医療機器の製品開発及び製造。グローバルに事業展開。



～精密押出成型～

ニーズの概要

◆ 商談ニーズの概要

- ・細径、肉薄チューブの押出成形
- ・樹脂を連続的に切り替えられる押出成形

◆ 商談ニーズの詳細

例)

材料:ポリアミド、ポリウレタン

※比較的柔軟な材料を使用。

構造:単層チューブ、

寸法:I.D. × O.D.= $\phi 0.85 \times 1.00\text{mm}$


その他編組チューブ、樹脂切替チューブ等

◆ 商談ニーズの補足説明

清潔な製造環境で特殊なチューブが
作製できる業者。

参考となるイラスト・写真など


肉薄チューブ

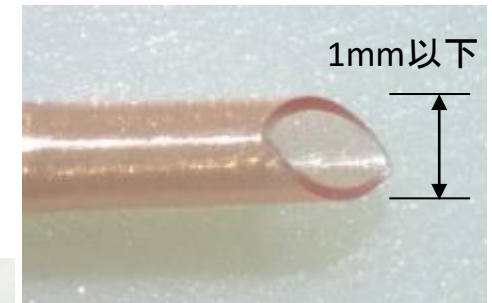

編組チューブ



樹脂切替チューブ

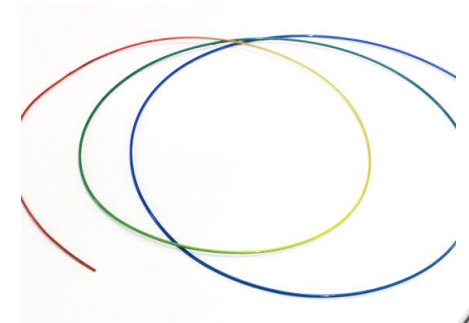

※イメージです


～特注設備・治具～

ニーズの概要


- ◆ 商談ニーズの概要
 - ・医療機器の製造に使用する特注設備の作製
- ◆ 商談ニーズの詳細
 - ・特殊な加工を行うカテーテル製造に使用する特注設備を構想～作製までできる業者
- ◆ 商談ニーズの補足説明
参考) 海外のカテーテル製造装置
<https://msi.equipment/>
<https://steegerusa.com/>
<https://www.bwtec.com/home>

参考となるイラスト・写真など


加熱加工機

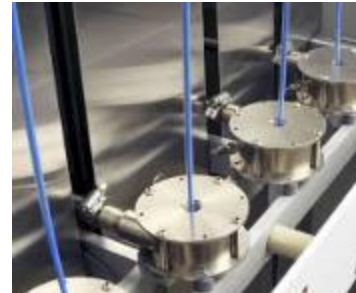

編組編み機

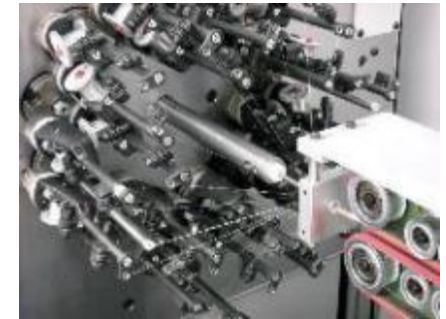

先端加工機

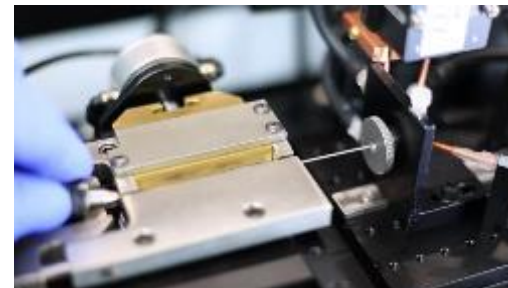



～コーティング剤～

ニーズの概要

- ◆ 商談ニーズの概要
 - ・機能性コーティング剤の作製
- ◆ 商談ニーズの詳細
 - ・潤滑性機能を持ったコーティング剤及び下処理剤の作製。
潤滑性: 無水マレイン酸、ヒアルロン酸等のコート剤
- ◆ 商談ニーズの補足説明
 - ・国内でコート剤、下処理剤を作製できる業者。

参考となるイラスト・写真など

親水性コート

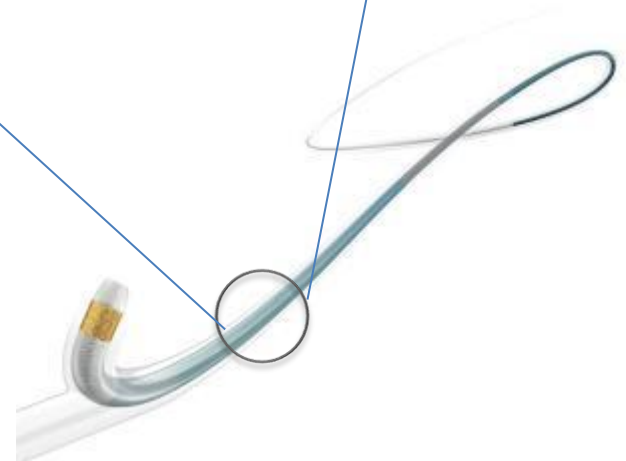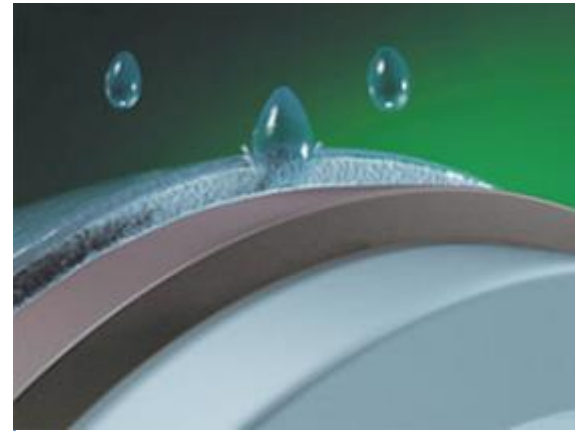

※イメージです

～ 金属加工 ～

ニーズの概要

◆ 商談ニーズの概要

・医療機器に組み付ける金属部品の作製

◆ 商談ニーズの詳細

・64チタンや純チタンなど埋め込み医療機器に用いられる材料を使用した金属部品

◆ 商談ニーズの補足説明

切削やレーザーなどにより特殊な金属を加工できる。また、使用量が少ない為、金属も調達できるルートを持っている業者。

参考となるイラスト・写真など

貫通穴(1mm以下)



ねじきり

